


LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.197.01500
Ölçüm Aralığı	25-1500 mg/L KOİ
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	170522
Kalibrasyon Tarihi	22.05.2017
Min. Raf Ömrü	05/19

KOİ Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri

mg/LKOİ	Abs
0	0.05
30	0.06
75	0.08
100	0.10
250	0.19
500	0.33
750	0.48
1000	0.62
1350	0.83
1500	0.92

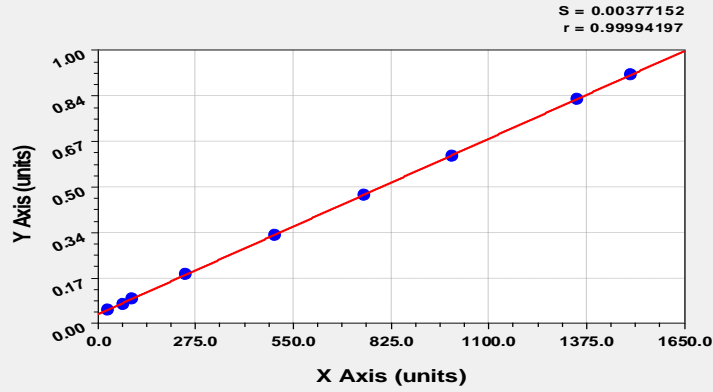

Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide - Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [S _{xo}], mg/L KOİ	6
Metod varyasyon katsayısı % [V _{xo}]	1.2
Güven aralığı (%95) ± mg/L KOİ [VB]	16
Doğruluk (%95) (± mg/L KOİ)	20
Minimum Tespit Limiti [LLD] (± mg/L KOİ)	25
Hassasiyet (mg/L KOİ / 0.01 Abs)	22

Kalibrasyon

Ö.Faruk Yapıcıoğlu
Kimyager

Kalite Kontrol Lab.Şefi

Prof.Dr.Zekeriya Yerlikaya
Kimyager