


LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.197.10000
Ölçüm Aralığı	500-10000 mg/L KOİ
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	170911
Kalibrasyon Tarihi	09.11.2017
Min. Raf Ömrü	09/19

KOI Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri

mg/L KOİ	Abs
0	0.00
750	0.16
1000	0.22
1501	0.34
3002	0.67
4501	1.00
5000	1.13
6000	1.36
8995	2.06
10000	2.29

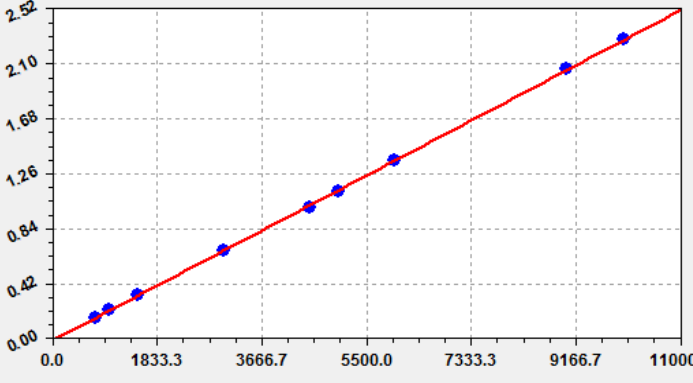

Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide - Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [Sxo], mg/L KOİ	47
Metod varyasyon katsayısı % [Vxo]	1.1
Güven aralığı (%95) ± [VB]	113
Doğruluk (%95) (± mg/L KOİ)	135
Minimum Tespit Limiti [LLD] (± mg/L KOİ)	170
Hassasiyet (mg/L KOİ / 0.01 Abs)	44

Kalibrasyon

Ö.Faruk Yapıcıoğlu
Kimyager



Kalite Kontrol Lab.Şefi

Prof.Dr.Zekeriya Yerlikaya
Kimyager

