


LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.198.60000
Ölçüm Aralığı	5-60 g/L KOİ
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	160927
Kalibrasyon Tarihi	27.09.2016
Min. Raf Ömrü	09/18

KOI Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri

mg/L KOİ	Abs
0	0.00
6000	0.27
10000	0.42
15000	0.65
20000	0.84
30000	1.23
35000	1.47
40000	1.66
45000	1.87
60000	2.48

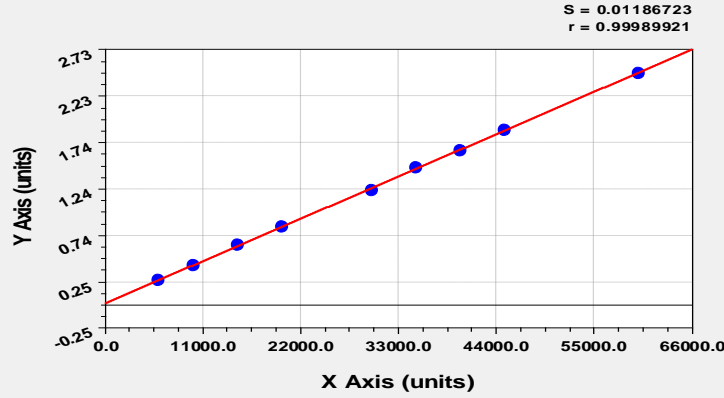

Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide - Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [Sxo], g/L KOİ	0.3
Metod varyasyon katsayısı % [Vxo]	1.1
Güven aralığı (%95) \pm g/L KOİ [VB]	0.7
Doğruluk (%95) (\pm g/L KOİ)	1
Minimum Tespit Limiti [LLD] (\pm g/L KOİ)	1.5
Hassasiyet (g/L KOİ / 0.01 Abs)	0.3

Kalibrasyon

Ö.Faruk Yapıcıoğlu
Kimyager

Kalite Kontrol Lab.Şefi

Prof.Dr.Zekeriya Yerlikaya
Kimyager