


LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.198.60000
Ölçüm Aralığı	5-60 g/L KOİ
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	161227
Kalibrasyon Tarihi	27.12.2016
Min. Raf Ömrü	12/18

KOI Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri

mg/L KOİ	Abs
0	0.07
5000	0.29
7000	0.38
9000	0.47
10500	0.53
15000	0.70
20000	0.87
30000	1.29
45000	1.90
50000	2.11

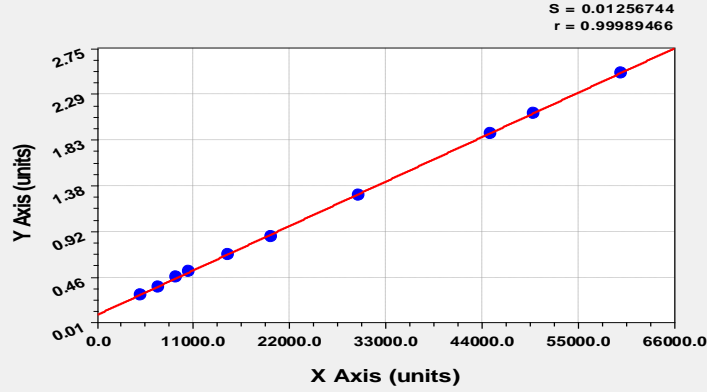

Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide - Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [Sxo], g/L KOİ	0.3
Metod varyasyon katsayısı % [Vxo]	1.7
Güven aralığı (%95) \pm g/L KOİ [VB]	0.8
Doğruluk (%95) (\pm g/L KOİ)	1
Minimum Tespit Limiti [LLD] (\pm g/L KOİ)	1.5
Hassasiyet (g/L KOİ / 0.01 Abs)	0.3

Kalibrasyon

Ö.Faruk Yapıcıoğlu
Kimyager

Kalite Kontrol Lab.Şefi

Prof.Dr.Zekeriya Yerlikaya
Kimyager