


LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.199.01500
Ölçüm Aralığı	25-1500 mg/L KOİ
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	171215
Kalibrasyon Tarihi	15.12.2017
Min. Raf Ömrü	12/19

KOİ Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri

mg/L KOİ	Abs
0	0.06
200	0.15
300	0.20
500	0.29
750	0.39
1000	0.50
1050	0.52
1250	0.61
1350	0.65
1500	0.71

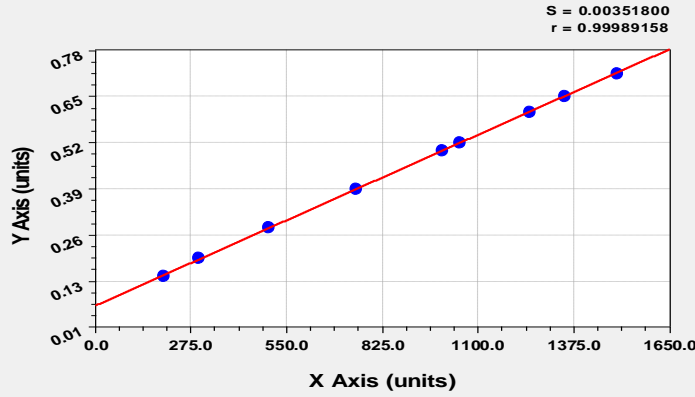

Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide - Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [Sxo], mg/L KOİ	8
Metod varyasyon katsayısı % [Vxo]	1.0
Güven aralığı (%95) \pm mg/L KOİ [VB]	20
Doğruluk (%95) (\pm mg/L KOİ)	20
Minimum Tespit Limiti [LLD] (\pm mg/L KOİ)	25
Hassasiyet (mg/L KOİ / 0.01 Abs)	22

Kalibrasyon

Ö.Faruk Yapıcıoğlu
Kimyager

Kalite Kontrol Lab.Şefi

Prof.Dr.Zekeriya Yerlikaya
Kimyager