


LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.199.15000
Ölçüm Aralığı	1000-15000 mg/L KOİ
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	170801
Kalibrasyon Tarihi	01.08.2017
Min. Raf Ömrü	08/19

KOI Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri

mg/L KOİ	Abs
0	0.07
1000	0.10
1350	0.12
1500	0.12
3000	0.19
5000	0.27
6001	0.33
8000	0.42
12000	0.59
15000	0.72

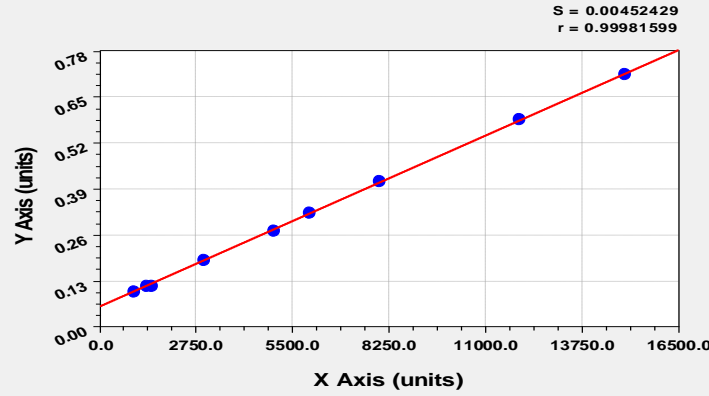

Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide - Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [S _{xo}], mg/L KOİ	103
Metod varyasyon katsayısı % [V _{xo}]	1.9
Güven aralığı (%95) ± [VB]	249
Doğruluk (%95) (± mg/L KOİ)	680
Minimum Tespit Limiti [LLD] (± mg/L KOİ)	274
Hassasiyet (mg/L KOİ / 0.01 Abs)	228

Kalibrasyon

Ö.Faruk Yapıcıoğlu
Kimyager

Kalite Kontrol Lab.Şefi

Prof.Dr.Zekeriya Yerlikaya
Kimyager