


LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.214.00323
Ölçüm Aralığı	0.03-2.3 mg/L NO ₂
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	150416
Üretim Tarih	15.04.2015
Min. Raf Ömrü	04/17

Nitrit Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri

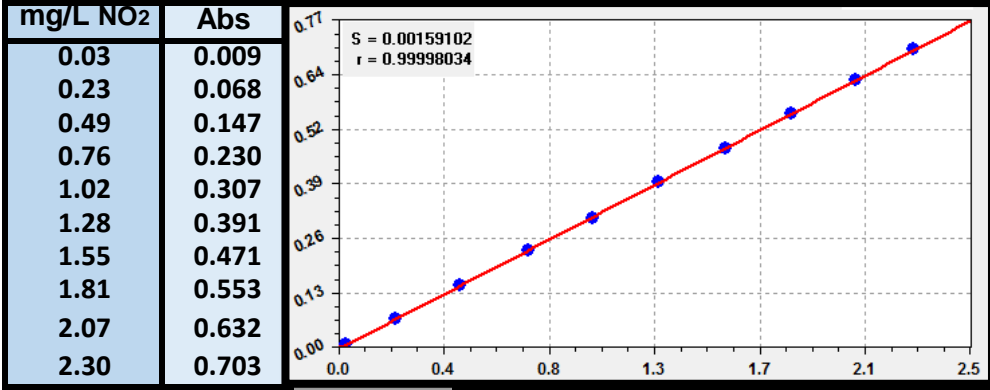

Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide -Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [Sxo], mg/L NO ₂	0.005
Metod varyasyon katsayısı % [Vxo]	0.4
Güven aralığı (%95) ± [VB]	0.02
Doğruluk (%95) (± mg/L NO ₂)	0.04
Minimum Tespit Limiti [LLD] (± mg/L NO ₂)	0.02
Metot Tespit Limiti [MDL] (± mg/L NO ₂)	0.02
Hassasiyet (mg/L NO ₂ / 0.01 Abs)	0.009

Kalibrasyon

Dilek Eroğlu
Kimyager

Kalite Kontrol Lab.Şefi

Dr.Zekeriya Yerlikaya
Kimyager