


## LOT KALİTE SERTİFİKASI

Matriks Test Kit Kat.No	1.189.150
Ölçüm Aralığı	10-150 mg/L N
Cihaz	Ref. Spektrofotometre
Lot No	171009
Üretim Tarih	09.10.2017
Min. Raf Ömrü	09/19

### Toplam Azot Standart Konsantrasyonlar ve Absorbans Değerleri

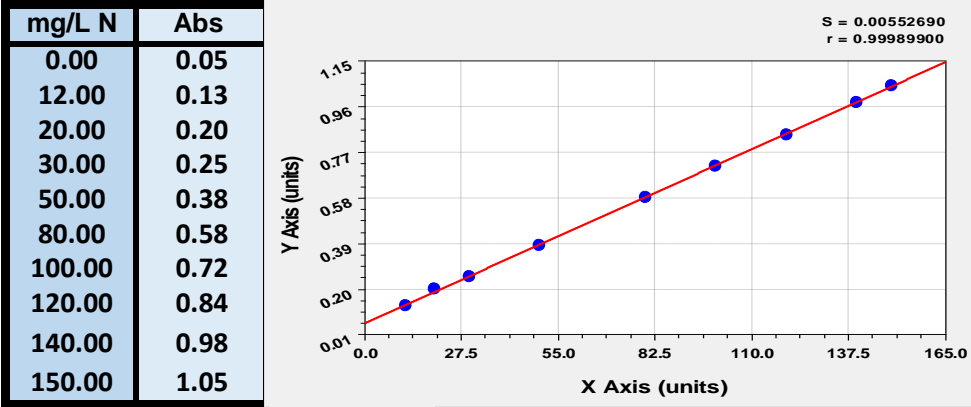

### Metot Performans Verileri

ISO 8466-1 / DIN 38402 A51 / Eurachem Guide - Ölçüm Belirsizliği

Performans Karakteristiği	Değer
Metod std sapması [Sxo], mg/L N	0.8
Metod varyasyon katsayısı % [Vxo]	1.2
Güven aralığı (%95) $\pm$ mg/L T-N [VB]	2
Doğruluk (%95) ( $\pm$ mg/L N)	1.6
Minimum Tespit Limiti [LLD] ( $\pm$ mg/L N)	4
Hassasiyet (mg/L N / 0.01 Abs)	1.4

### Kalibrasyon

Ö.Faruk Yapıcıoğlu  
Kimyager

### Kalite Kontrol Lab.Şefi

Prof.Dr.Zekeriya Yerlikaya  
Kimyager