


Matriks QualityCheck

KONTROL KARTI ^[1] / CONTROL CHART

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

Ölçüm Aralığı/Measuring range: 1000 – 15000 mg/L KOİ / COD

Cihaz/Instrument: _____ Analizci/Tester: _____

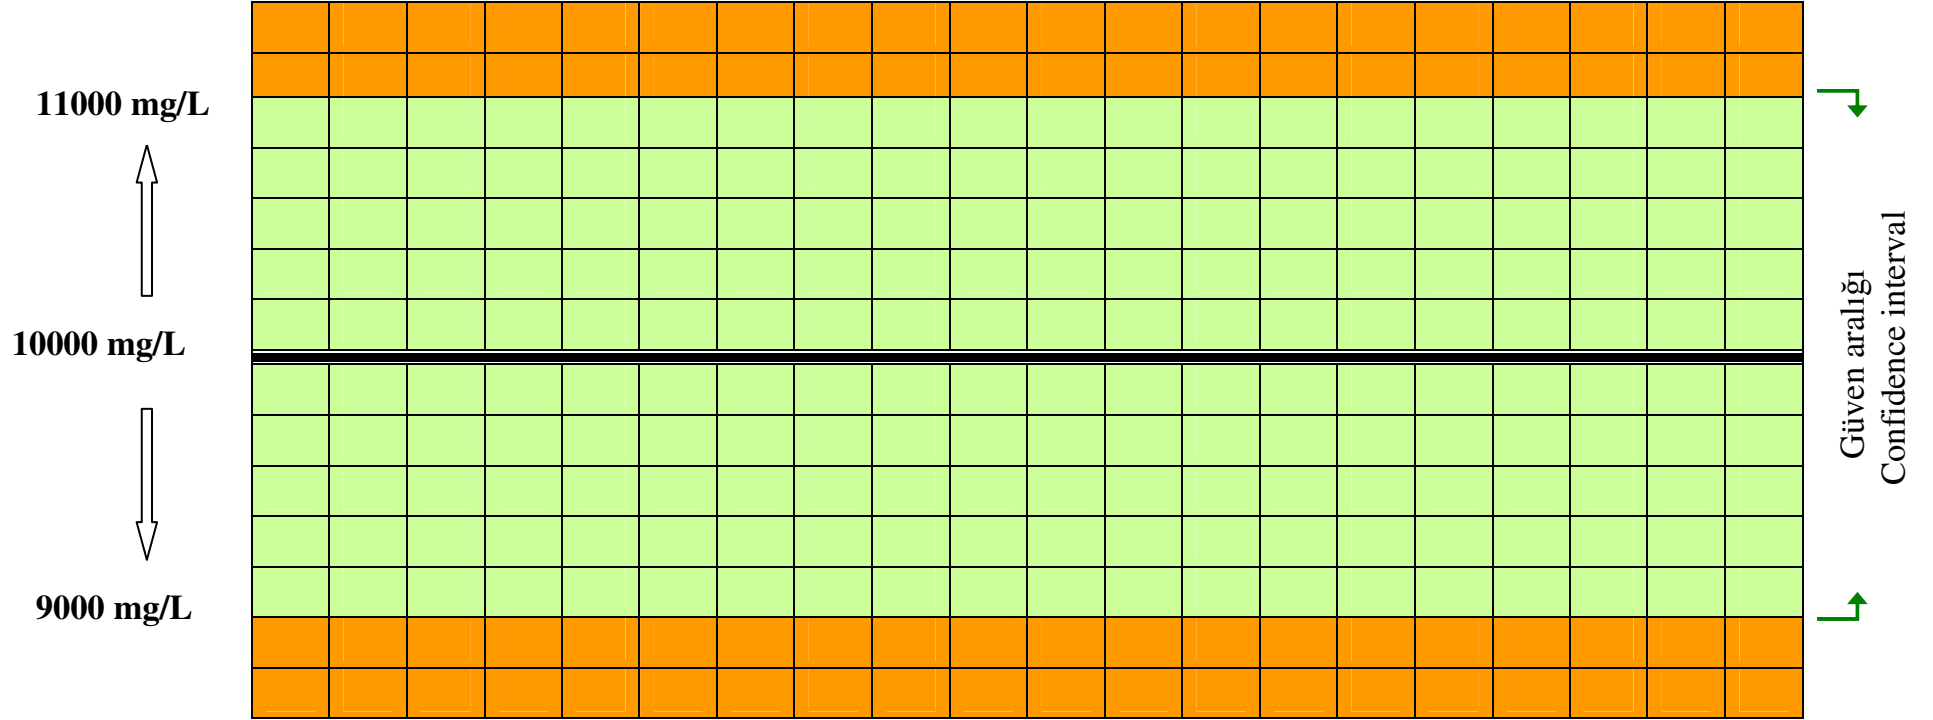

Ölçüm değeri Measurement value mg/L KOİ / COD																			
Tarih Date																			

^[1] EPA 410. 4 KOİ Standart Metodu için günlük periyotta Kalite Kontrol Kriteri, standart değer +/- % 10 u dur.