


Matriks QualityCheck

KONTROL KARTI ^[1] / CONTROL CHART

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

Ölçüm Aralığı/Measuring range: 4 – 40 mg/L KOİ / COD

Cihaz/Instrument: _____ Analizci/Tester: _____

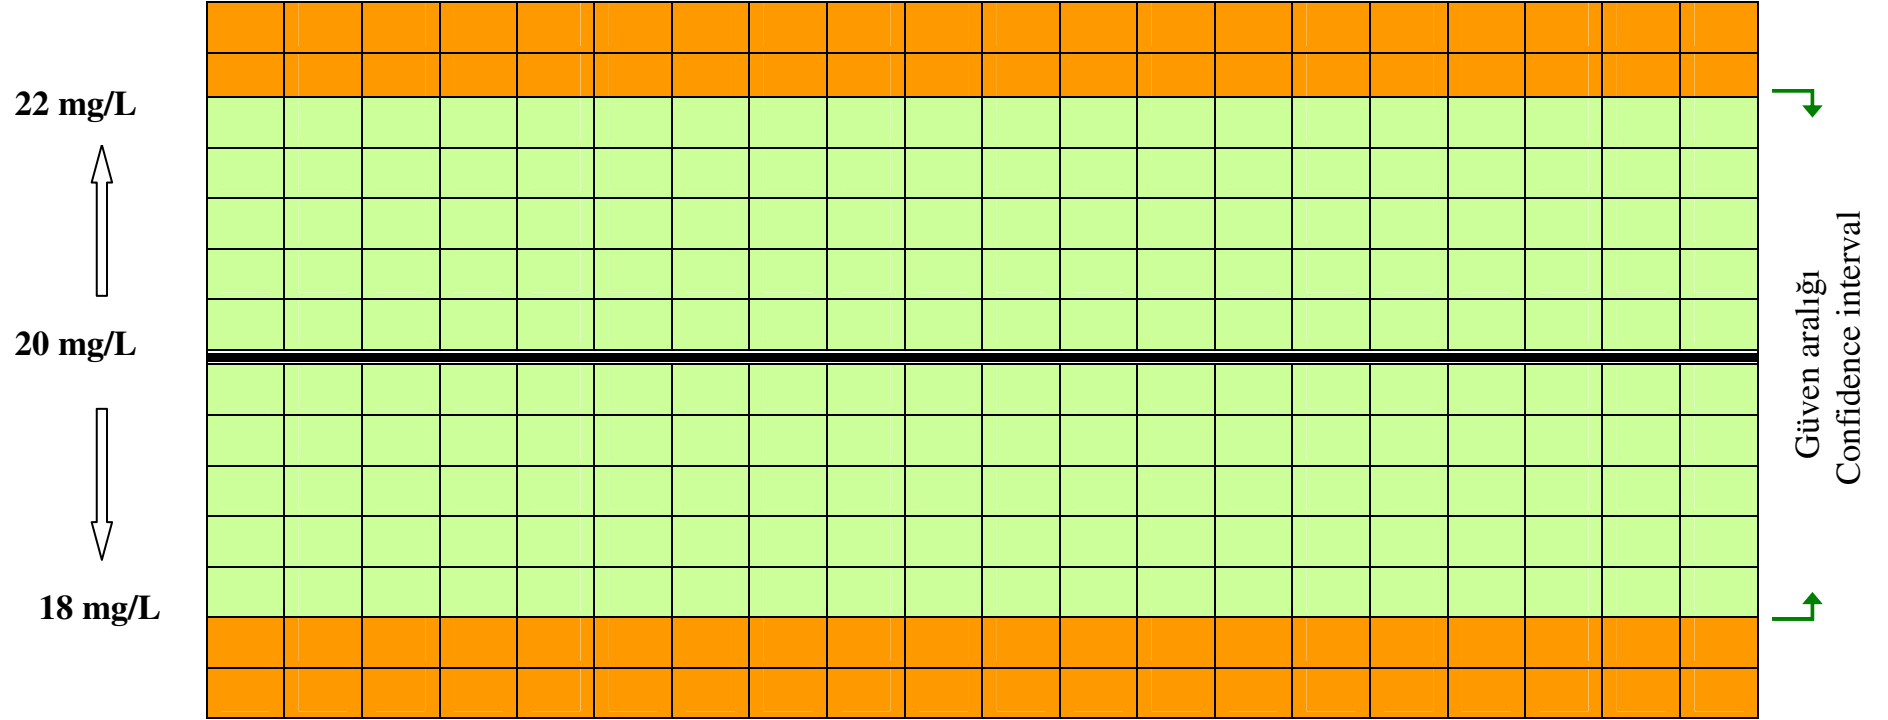

| Ölçüm değeri Measurement value mg/L KOİ / COD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tarih Date | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

^[1] EPA 410. 4 KOİ Standart Metodu için günlük periyotta Kalite Kontrol Kriteri, standart değer +/- % 10 u dur.